

医療施設長 様

鹿児島市医師会臨床検査センター
センター長 上ノ町 仁

基準範囲設定のお知らせ

日頃より当臨床検査センターをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、下記の項目において「基準範囲」（参考基準値）を設定いたしましたのでご案内いたします。
注意事項に記載しています通り、採血から測定までの経過時間によって測定値が低値化いたします。
該当する検査項目をご依頼いただく際は注意事項をご確認の上、ご活用くださいますようよろしくお願い申し上げます。

記

■ 実施日 2022 年 7 月 14 日（木）ご依頼分より


■ 対象項目/変更一覧

検査項目・コード JLAC10	変更内容	新	現	備考
血清血糖 0107600 (1076) 3D010-0000-023-272-01	基準 範囲	70~109 mg/dL	設定なし	容器：生化学 茶色 A

【注意事項】

- ・0130100 (1301) グルコース（血糖）：材料_血漿 と同じ基準値を設定しました。
- ・採血後、全血のまま放置すれば「血清血糖」は低下します。
室温保存では1時間あたり約10mg/dL低下します。（次頁参照）
- ・より正確な血糖値をお求めの際は、0130100 (1301) グルコース（血糖）：専用容器C 灰色（フッ化ナトリウム入り）をご依頼ください。
- ・報告書に基準範囲が印字されます。電子カルテへの設定につきましては、ご施設様で電子カルテメーカー様へ対応いただくよう、ご連絡をお願いいたします。

全血保存によるグルコースの経時変化

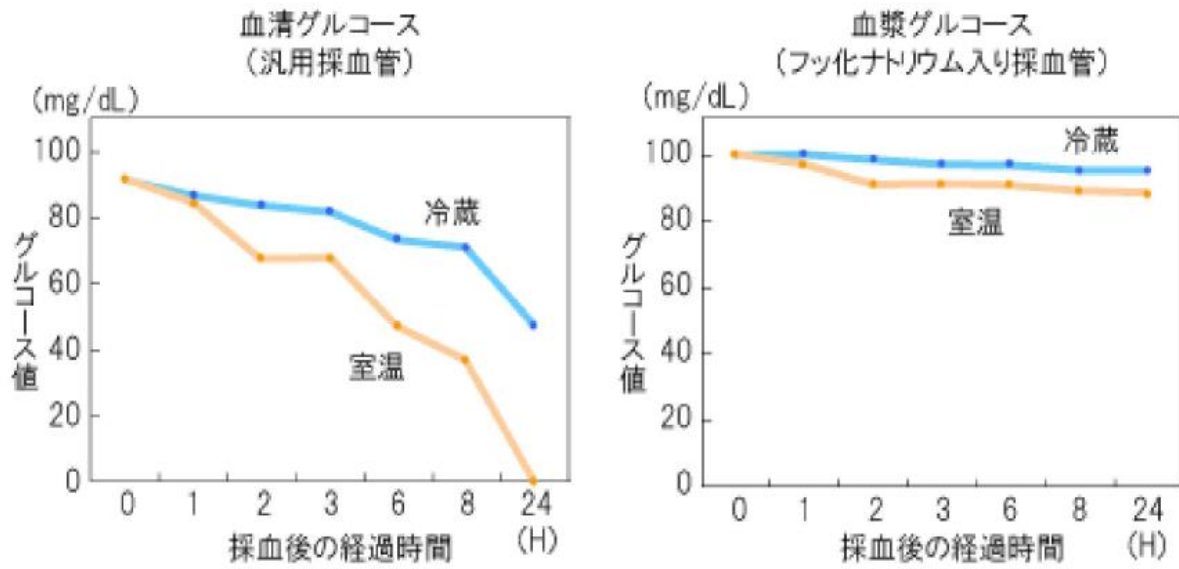

〔参考〕

糖尿病検査のすべて。Medical Technology 臨時増刊 30 (13)、2002
臨床検査法提要 改訂第32版、2005